

충전식 오픈형 보청기 사용설명서

Intrigue AI



충전식 제품

mRIC R (Micro Receiver-In-Canal)
Rechargeable

RIC RT (Receiver-In-Canal)
Rechargeable with Telecoil

안전을 위한 주의사항

필수 제품 정보

다음의 추가 정보는 미국 식품의약국(FDA) 규정을 준수하기 위해 제공됩니다:

⚠ 경고: 사용 전 주의사항

다음의 증상을 가진 예비 보청기 사용자는 보청기 착용 전에 가능한 신속하게 귀 전문의와 상담하시길 권고합니다.

- 최근 6개월 이내에 귀에서 분비물, 고름 또는 피가 나온 경우
- 귀 통증 또는 불편감이 있는 경우
- 과거 과도한 귀지가 있거나 외이도에 이물질이 있을 것으로 의심되는 경우
- 최근 또는 장기간의 어지러움이 있는 경우
- 최근 6개월 이내에 갑작스럽고 빠르게 악화되는 청력 손실이 있는 경우
- 한 귀에서만 난청이나 울림(이명)이 있거나 양쪽귀의 청력에 현저한 차이가 있는 경우
- 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz에서 15 dB 이상의 기도 골도 차가 있는 경우

⚠ 경고: 132 dB SPL 이상의 출력이 있는 경우

보청기의 최대 출력이 132 dB SPL을 초과하는 경우, 보청기 사용자의 잔존 청력을 손상시킬 수 있으므로 선택과 착용에 특별한 주의를 기울여야 합니다.

⚠ 주의사항: 기도형 보청기는 청력 보호용이 아닙니다.

장시간은 물론 짧은 시간동안에도 과도한 큰소리를 경험한다면 보청기를 제거해야 합니다. 소음이 큰 장소에 있다면, 보청기를 착용하는 대신 적절한 종류의 청각 보호 장치를 사용해야 합니다. 일반적으로 소음이 큰 장소에서 귀마개를 사용해야 한다면, 보청기는 빼고 귀마개를 사용해야 합니다.

⚠ 주의사항: 소리 출력은 불편하거나 고통스럽지 않아야 합니다.

소리 출력이 불편하게 크거나 고통스러울 경우 볼륨을 낮추거나 보청기를 제거해야 합니다. 계속 소리출력이 불편하다면, 전문가와 보청기의 소리를 더 조절해야 할 수도 있습니다.

⚠ 주의사항: 부품이 귓속으로 들어갔을 경우 의료적인 도움이 필요할 수 있습니다.

보청기의 이어팁과 같은 부품이 귓속으로 들어간 경우, 손가락으로 쉽게 제거할 수 없다면 가능한 한 빨리 의료적인 도움을 받아야 합니다. 집게나 면봉을 사용하려고 시도해서는 안됩니다. 이는 해당 부분을 귀 안쪽으로 더 밀어 넣을 수 있으며, 고막이나 외이도에 심각한 손상을 초래할 수 있습니다.

안전을 위한 주의사항

참고: 보청기 사용을 시작할 때 발생할 수 있는 사항입니다.

보청기는 청력 저하를 겪는 많은 사용자들에게 이점을 줄 수 있습니다. 그러나 정상적인 청력으로 회복시키지는 않으며, 소음 속에서 청취에 어려움을 겪을 수 있습니다. 또한, 보청기는 청력 손실을 일으키는 의료적인 상태를 예방하거나 개선하지는 않습니다.

보청기 사용을 시작하는 사용자들은 몇 주 동안 적응이 필요할 수 있습니다. 많은 사용자들이 훈련이나 상담을 통해 장치를 보다 효과적으로 활용할 수 있다는 것을 알아주시길 바랍니다.

양쪽 귀에서 청력 손실이 발생하는 경우, 특히 소음이 많은 환경과 같이 청취로 인해 피로를 느끼는 상황에서 양쪽 귀에 보청기를 사용하여 더 많은 효과를 얻을 수 있습니다.

참고: 청각 보청기와 관련된 상해, 기능 장애 또는 기타 부작용에 대해 FDA에 고지하십시오.

보청기와 관련된 문제를 신고하려면 문제 발생 후 가능한 한 빨리 FDA에 정보를 제출해야 합니다. FDA는 이를 "부작용"이라고 부르며, 이는 귀의 피부 자극, 장치로 인한 상해(절단 또는 긁힘, 과열된 배터리로 인한 화상 등), 장치 부분이 귀에 걸리는 등을 포함할 수 있습니다. 또한, 장치 사용으로 인해 갑작스럽게 청력이 악화되는 경우 등이 있을 수 있습니다.

신고 안내는 <https://www.fda.gov/Safety/MedWatch>에서 확인할 수 있으며, 1-800-FDA-1088로 전화 문의가 가능합니다. 또한 FDA에 이메일로 양식을 다운로드하여 제출할 수도 있습니다.

보청기는 정상적인 청력으로 회복시키지 않으며, 유기질적인 조건으로 인한 청각 장애를 예방 또는 개선하지는 않습니다. 보청기 사용은 청각 재활의 일부일 뿐이며, 청각 훈련과 입 모양 읽기 훈련이 요구될 수 있습니다. 대부분의 경우, 보청기 사용 빈도가 낮으면 사용자는 효과를 보기 어려울 수 있습니다.

일부 보청기 사용자들은 휴대전화 사용 시, 보청기에서 웅웅거리는 소리를 들었다고 보고했습니다. 이는 휴대전화의 기종에 따라 휴대전화와 보청기가 호환되지 않을 수 있음을 나타냅니다. 휴대전화와 보청기에 대한 잠재적인 소음 원인임은 잘 알려져 있습니다. 스타키보청기는 디지털 무선 장치에 대한 보청기 면역을 정의하는 두 가지 기준을 준수하는 테스트를 진행했으며, ANSI C63.19-2019와 IEC 60118-13:2019에 의해 정의된 사용자 호환성 기준을 충족합니다.

반갑습니다!

Intrigue AI와 함께
더 나은 청력으로
최고의 삶을
즐겨보세요.

Intrigue AI를 소개합니다.

Intrigue AI로 고객님의 더 나은 소리를 선사할 수 있게되어 기쁩니다.

보청기 사용설명서를 통해서 Intrigue AI의 기능을 알아보고 일상생활의 다양한 분야에서 최대한 활용해 보십시오. Intrigue AI와 함께하면 더 잘 듣고, 더 나은 삶을 경험하실 수 있습니다.

Intrigue AI는 스마트폰과 스트리밍 하면 훨씬 더 많은 기능을 사용할 수 있다는 사실, 알고 계신가요? 자세한 내용은 **모바일 앱 설명서를 참조하여 설정**하십시오.

제품 구성

구입한 보청기 선택:

mRIC R



RIC RT



일련번호

왼쪽: _____

오른쪽: _____

보청기에는 탈착이 불가능한 충전식 리튬 이온 배터리가
내장되어 있습니다.

목차

1. 안전을 위한 주의사항	2
2. 보청기에 대한 정보	
보청기 명칭	10
보청기 사용하기	12
보청기 관리하기	21
3. 문제 해결 가이드	28
4. 기타 안내사항	
안전정보	32
FCC정보	37
규제정보	38
사용 시 주의사항	40
KC 인증정보	42


보청기 알아보기

- 보청기 명칭
- 보청기 사용하기
- 보청기 관리하기


보청기 명칭

보청기 부분 명칭

1. 케이블
2. 마이크
3. 사용자 조절 버튼
mRIC R : 푸시 버튼
RIC RT : 로커 스위치
4. 리시버
5. 귀지방지망
6. 제조사명, 제품명, 일련번호
7. 충전단자
8. 보청기 좌/우 위치 표시(옵션)
(빨간색 - 오른쪽, 파란색 - 왼쪽)
9. 리시버 지지대(옵션)
10. 리시버 좌/우 위치 표시
(빨간색 - 오른쪽, 파란색 - 왼쪽)
11. 이어버드
12. 맞춤형 이어몰드(옵션)
13. 고출력 맞춤형 이어몰드(옵션)

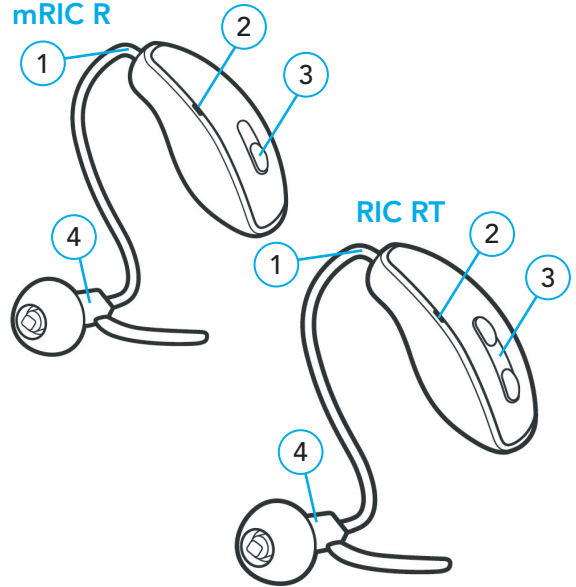

참고: 아래 그림은 mRIC R 및 RIC RT 제품 모두 해당됩니다.

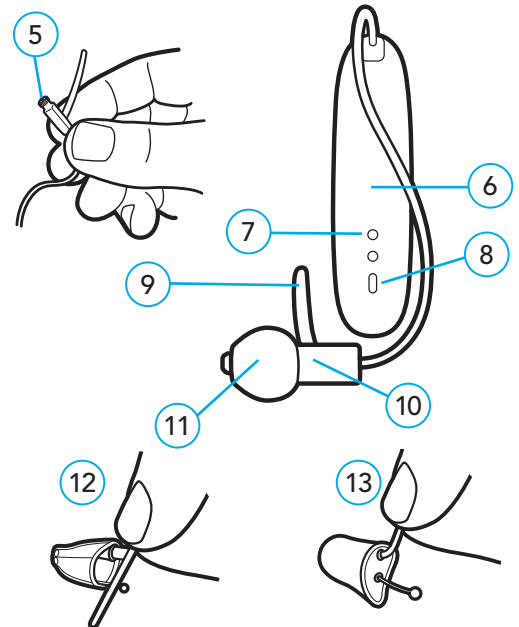

보청기 사용하기

1단계: 보청기 충전하기

구입한 충전기 선택:

- StarLink 일반형 충전기
- StarLink 고급형 미니 충전기
(리튬 이온 배터리 내장)

보청기를 처음 사용하신다면, 사용하기 전에 충분히 충전해 주세요. 충전기에 대한 자세한 사용방법은 충전기 사용설명서를 참조하십시오.


참고 - StarLink 일반형 충전기는 반드시 외부 전원코드(예시: 멀티탭, 벽면 콘센트 등)에 연결되어 있어야 원활한 충전이 가능합니다

StarLink 고급형 미니 충전기는 외부 전원코드(예시: 멀티탭, 벽면 콘센트 등)에 연결되어 있거나 내장된 배터리가 충전되어 있어야 원활한 충전이 가능합니다.


보청기 사용하기

2단계: 보청기 착용하기

1. 충전기에서 보청기를 꺼내서, 보청기의 케이블과 이어버드(이어몰드)가 귀 앞쪽(얼굴 방향)으로 향하게 한 후 보청기 본체를 귀 뒤쪽(머리 방향)으로 걸어줍니다.

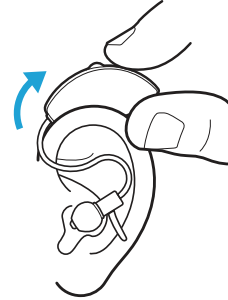

2. 손가락 끝으로 이어버드(이어몰드)를 부드럽게 외이도의 안쪽으로 밀어 넣어줍니다. 이 때 케이블은 들뜨는 부분 없이 귀의 위쪽에 딱 맞닿도록 착용합니다.

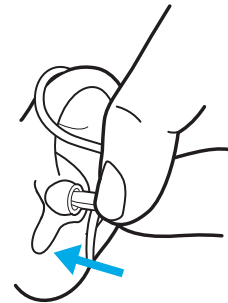

보청기 사용하기

3. 리시버 지지대가 있다면, 귀의 안쪽 공간에 지지대의 끝이 뒤쪽(머리 방향)으로 구부러지도록 하여 이어버드(이어몰드)가 잘 고정되도록 합니다.




참고:

- 보청기 착용이 익숙해지기 전, 귀에 홍반이나 염증이 발생할 수도 있습니다. 편안한 착용을 위한 맞춤형 이어몰드 및 다른 사이즈의 이어버드에 대해서는 보청기 전문가에게 문의하십시오.
- 이어몰드, 이어버드 착용 시 알레르기 반응이 발생한다면 대체 재질로 제작할 수 있습니다. 이는 보청기 전문가에게 문의하십시오.
- 보청기 사용 중 심하게 붓거나 과도한 귀지 또는 분비물 발생과 같은 예기치 않은 상황이 발생한다면 즉시 보청기 전문가에게 문의하십시오.


보청기 사용하기

3단계: 보청기 빼기

1. 리시버 지지대가 있다면, 지지대를 먼저 제거한 후 엄지와 검지를 이용하여 이어버드(이어몰드)를 부드럽게 잡아서 빼줍니다.

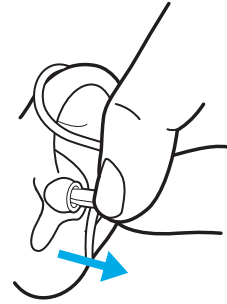

2. 귀 뒤쪽에 있는 보청기 본체를 위쪽으로 들어 올려서 빼줍니다.

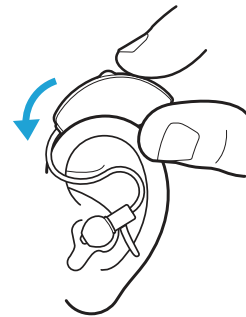

보청기 사용하기

전원 켜기 / 끄기

보청기를 켜거나 끌 때는 알림음이 울립니다.

- **켜기:** 보청기의 알림음이 높은 음 쪽으로 재생됩니다.
- **끄기:** 보청기의 알림음이 낮은 음 쪽으로 재생됩니다.

보청기는 충전기나 사용자 조절 버튼을 이용하여 켜거나 끌 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 페이지의 표를 참조하십시오.

보청기 사용하기

	켜기	끄기
충전기	보청기는 충전기에서 분리하면 자동으로 전원이 켜집니다. 보청기는 사용자가 완전히 착용한 상태에서 켜질 수 있도록, 보청기의 전원이 켜진 후 소리가 들리기까지 약 3초의 시간이 소요될 수 있습니다.	보청기를 충전기의 충전 슬롯에 올려놓으면 자동으로 전원이 꺼지고 충전이 시작됩니다.
사용자 조절 (mRIC R: 푸시 버튼)	보청기의 전원을 수동으로 꺾을 경우, 푸시 버튼을 다시 누르면 보청기 전원이 켜집니다. 보청기는 사용자가 완전히 착용한 상태에서 켜질 수 있도록, 보청기의 전원이 켜진 후 소리가 들리기까지 약 3초의 시간이 소요될 수 있습니다.	푸시 버튼을 3초 이상 길게 누르면 보청기의 전원을 수동으로 끌 수 있습니다.
사용자 조절 (RIC RT: 로커 스위치)	보청기의 전원을 수동으로 꺾을 경우, 로커 스위치의 상단 버튼을 다시 누르면 보청기 전원이 켜집니다. 보청기는 사용자가 완전히 착용한 상태에서 켜질 수 있도록, 보청기의 전원이 켜진 후 소리가 들리기까지 약 3초의 시간이 소요될 수 있습니다.	로커 스위치의 상단 또는 하단의 버튼을 3초 이상 길게 누르면 보청기의 전원을 수동으로 끌 수 있습니다.

보청기 사용하기

예상 배터리 사용시간

배터리 사용시간은 스트리밍 사용시간에 따라 달라집니다.

- **mRIC R**
 - 스트리밍 해제 시: 최대 41시간
 - 스트리밍 사용 시: 최대 33시간
- **RIC RT**
 - 스트리밍 해제 시: 최대 51시간
 - 스트리밍 사용 시: 최대 45시간

배터리 부족 알림음

- **배터리 부족:** 배터리 전압이 낮을 경우 '배터리' 라는 배터리 부족 알림음을 보청기를 통해 들을 수 있습니다. 배터리 잔량이 대략 30분 정도 남아있을 때 울립니다.

참고: 환경소음 수준과 제품 사용 환경에 따라 배터리 부족 알림음이 울린 후 배터리 방전까지의 실제 시간은 차이가 있을 수 있습니다.

- **배터리 방전 :** 배터리가 방전되어 보청기가 꺼지기 직전에도 배터리 부족 알림음이 울릴 수 있습니다.

보청기 사용하기

사용자 조절

보청기 사용자 조절 버튼을 이용하여 보청기를 제어할 수 있습니다. 사용자 조절은 보청기 전문가를 통해 설정할 수 있으며, 내 보청기의 사용자 조절을 어떻게 설정했는지는 보청기 전문가에게 문의하십시오.

사용자 조절 버튼은 세 가지 방식으로 사용 가능합니다:

- **짧게 누르기:** 사용자 조절 버튼을 1초 정도 눌렀다 떼기
- **길게 누르기:** 사용자 조절 버튼을 3초 정도 길게 누르기
- **탭 컨트롤:** 보청기 사용자 조절 버튼이나 근처를 두 번 두드리기

구입하신 보청기는 다음과 같이 설정되어 있습니다.

구분	설정된 기능
짧게 누르기(1초)	
길게 누르기(3초)	
탭 컨트롤	

Intrigue AI는 스마트폰을 이용하여 훨씬 더 많은 기능을 제어하고 사용할 수 있다는 사실, 알고 계신가요? 자세한 내용은 **모바일 앱 설명서**를 참조하여 설정하십시오.

보청기 사용하기

전화 통화하기

보청기는 전화 통화 시에도 효과적으로 의사소통할 수 있도록 최적화되어 있습니다.

- **유선전화**

Intrigue AI는 깨끗한 통화품질을 위한 전화 메모리 설정 기능을 가지고 있습니다. 자세한 내용은 보청기 전문가에게 문의하십시오.

- **스마트폰**

Intrigue AI는 스트리밍을 통해 스마트폰으로 온 전화를 보청기로 들을 수 있는 기능이 포함되어 있습니다. 보청기와 **스트리밍 가능한 스마트폰** 기종과 **자세한 내용은 모바일 앱 설명서를 참조하십시오.**

보청기를 이용한 전화 통화가 어려우신 경우 보청기 전문가에게 문의하십시오.

보청기 관리하기

보청기를 항상 깨끗하게 유지하는 것이 중요합니다. 이는 열, 습기 및 이물질로 인해 성능이 저하되는 것을 방지하고 보청기 수명을 연장시켜 줍니다.

1. 보청기는 절대 물, 알코올, 세척제 또는 오일을 사용하여 세척해서는 안 되며, 보청기를 분해하거나, 보청기 내부로 청소도구를 넣지 마십시오.
2. 보청기용 충전기는 제공해 드린 청소솔을 이용하여 충전 슬롯에 이물질을 제거합니다.
3. 보청기는 청소 시 부주의로 떨어트리면 파손의 위험이 있으니 비교적 안전한 탁자나 책상 위에서 제공해 드린 전용 청소솔 및 부드럽고 마른 천을 이용하여 마이크와 리시버 주변의 귀지나 미세한 먼지를 제거하고 닦아줍니다.

자세한 보청기 관리 방법은 보청기 전문가에게 문의하십시오.

보청기 관리하기

보청기 보관하기

보청기를 착용하지 않을 때는 안내해 드리는 방법에 따라 보청기가 손상되지 않도록 보관하시는 것을 권장합니다:

- 보청기를 사용하지 않을 때는 안전을 위해 보관 케이스 또는 충전기 안에 넣어서 보관하십시오.(충전기에 보관하는 동안 보청기가 충전되어 다시 착용할 때 바로 사용 가능합니다.)
- 보청기는 서늘하고 건조한 장소에 보관하십시오.(직사광선이 들어오는 곳이나 온도가 너무 높은 곳 또는 냉장고와 같이 온도가 너무 낮은 곳에는 보관하지 마십시오.)
- 보청기를 찾기 쉬운 곳에 보관하십시오. 또한 영아, 유아, 어린이 또는 반려동물의 손이 닿지 않는 화장대나 탁자 등에 보관하십시오.

자세한 보청기 보관방법은 보청기 전문가에게 문의하십시오.


보청기 관리하기

보청기 귀지방지망


보청기에는 1회용 귀지방지망이 부착되어 있을 수 있습니다. 귀지방지망은 보청기의 리시버에 귀지가 쌓이는 것을 방지 해주며, 보청기에 이물질이 쌓여서 평소보다 소리가 잘 들리지 않는 경우에는 교체하는 것을 권장합니다.

귀지방지망 교체하기:

1. 보청기에서 사용한 귀지방지망에 스틱의 노란 쪽 끝을 삽입합니다.

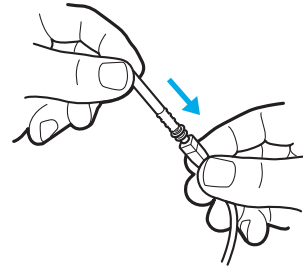


2. 스틱을 바깥쪽으로 똑바로 당겨 사용한 귀지방지망을 제거합니다. 이때 스틱을 비틀지 마십시오.

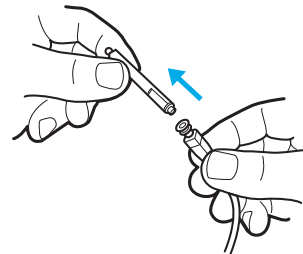


보청기 관리하기

3. 스틱의 반대쪽을 사용하여 깨끗한 귀지방지망을 보청기에 삽입한 후 눌러줍니다.

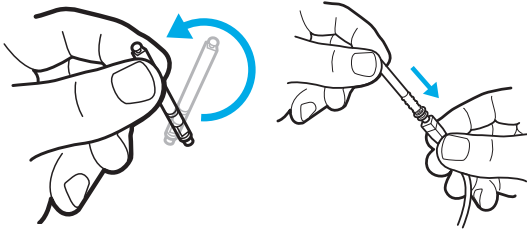

4. 스틱을 똑바로 당겨서 빼내고 스틱은 폐기합니다.




보청기 관리하기

보청기 이어버드


보청기의 이어버드는 정기적으로 교체하는 것을 권장합니다. 또한 이어버드가 헐거워진 경우, 과도하게 눌러서 모양이 변했을 경우, 기름기나 습기로 인해 변색된 경우나 이어버드에 이물질이 쌓여서 평소보다 소리가 잘 들리지 않는 경우에도 교체해야 한다는 신호가 될 수 있습니다.

이어버드 교체하기:

1. 기존에 보청기의 리시버에 장착되어 있던 이어버드는 당겨서 제거합니다.

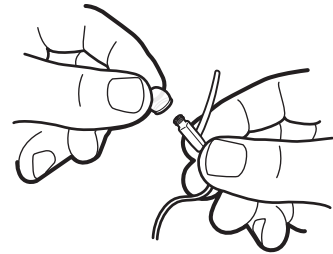


2. 보청기의 케이블과 리시버가 만나는 부분을 잡습니다.




보청기 관리하기


3. 새 이어버드의 중앙을 리시버의 끝부분에 놓습니다.



4. 이어버드가 리시버에 끼워지도록 누릅니다.



5. 이어버드가 리시버의 나사산 부분을 완전히 덮었는지 확인합니다.



문제 해결 가이드

문제 해결 가이드

어떤 경우에도 보청기가 작동하지 않을 때 절대 직접 수리하지 마십시오. 이는 무상수리 보증 조건에서 제외될 뿐만 아니라 더 큰 고장을 야기할 수 있습니다.

보청기가 작동하지 않거나 성능이 떨어지는 경우 문제 해결 가이드를 참조하십시오. 만약 문제가 지속된다면 보청기 전문가에게 문의하십시오.

증상	추정 원인	해결방안
보청기 소리가 작음	이어버드(이어몰드) 막힘	1. 보청기와 이어버드 (이어몰드) 청소. 2. 필요에 따라 귀지방지막 교체.
	이물질이 쌓임	보청기의 마이크와 리시버를 청소솔로 청소.
	청력의 변화	보청기 전문가와 상담.

문제 해결 가이드

증상	추정 원인	해결방안
보청기 성능이 일정하지 않음	이어버드(이어몰드) 막힘	1. 보청기와 이어버드 (이어몰드) 청소. 2. 필요에 따라 귀지방지막 교체.
	보청기 재부팅 필요	1. 보청기를 충전기에 넣어 충전이 시작될 때까지 올려 둬. 2. 충전이 시작된 것을 확인 후 보청기와 충전기를 분리하여 보청기의 전원을 켜.
보청기의 소리가 명확하지 않거나 왜곡됨	이어버드(이어몰드) 막힘	1. 보청기와 이어버드 (이어몰드) 청소. 2. 필요에 따라 귀지방지막 교체.
	보청기 재부팅 필요	1. 보청기를 충전기에 넣어 충전이 시작될 때까지 올려 둬. 2. 충전이 시작된 것을 확인 후 보청기와 충전기를 분리하여 보청기의 전원을 켜.
	보청기 결함	보청기 전문가와 상담.

문제 해결 가이드

증상	추정 원인	해결방안
보청기의 소리가 나지 않음(보청기 작동 정지)	이어버드(이어몰드) 막힘	1. 보청기와 이어버드 (이어몰드) 청소. 2. 필요에 따라 귀지방지막 교체.
	충전필요	충전기에 충전 상태 표시등(LED)의 깜박임이 중지될 때까지 충전.
	리시버 케이블 결함	보청기 전문가와 상담.
	리시버가 보청기에 완전히 장착되지 않음	보청기에서 리시버를 완전히 분리했다가 다시 연결.
충전기 안에 있는 보청기에서 휘파람 소리가 들림	보청기가 충전기에 올바르게 삽입되지 않음	1. 충전기에서 보청기를 완전히 분리함. 2. 보청기의 이어버드(이어몰드)가 충전기 보관함에 들어가는 방향으로 올바르게 다시 올려 둠.
	충전 슬롯 청소 필요	1. 충전기에서 보청기를 완전히 분리함. 2. 제공해 드린 청소솔을 이용하여 충전 슬롯에 이물질 제거함. 3. 보청기의 이어버드(이어몰드)가 충전기 보관함에 들어가는 방향으로 올바르게 다시 올려 둠.

기타 안내사항

- 안전정보
- FCC정보
- 규제정보
- 사용 시 주의사항
- KC 인증정보

안전정보

사용목적:

기도형 보청기는 소리를 증폭시키는 착용 가능한 장치로, 손실된 청력을 보완하기 위해 제작되었습니다. 보청기는 경도에서 심도의 청각 손실을 치료하기에 적합한 다양한 증폭/출력 수준으로 제공됩니다.


보청기는 공공 및 주거 환경에서 작동하도록 설계되었으며, 의료기기용 국제 전자기 호환성 방출 및 면역 표준에 따라 작동하도록 설계되었습니다. 그러나 전력선 장애, 공항의 금속 탐지기, 다른 의료 기기로부터의 전자기장, 라디오 신호, 정전기 방출로 인한 간섭이 발생할 수 있습니다.

다른 의료기기를 사용하거나 심장 제세동기나 심박조율기 같은 이식 가능한 의료기기를 착용하고 있는 경우, 보청기가 착용하는 의료기기에 간섭이 우려된다면, 간섭 위험에 대한 정보는 의사 또는 의료기기 제조사에 문의하시기 바랍니다.

보청기는 MRI 검사 도중이나 고압 산소 치료실과 같은 환경에서 착용을 금합니다.

보청기는 IEC 60601-1 의료기기표준하의 B형으로 분류됩니다.

보청기는 석탄 광산이나 특정 화학 공장 등 폭발성 환경에서 작동하는 공식적인 인증은 받지 않았습니다.

 보청기는 -10°C (14°F)에서 +45°C (113°F), 상대습도 10%-95%, 압력 70 kPa - 106 kPa(해수면 아래 1,200 ft (380 m)에서 해발 10,000 ft (3,000 m)까지에 해당) 범위 내에서 보관 및 운송되어야 합니다.

보청기 충전 온도 범위는 10°C (50°F)에서 40°C(104°F) 사이이며, 상대습도는 10%-95%이며, 압력은 70 kPa-106 kPa입니다.

⚠ 주의사항:

- 제품이 열기로 온도가 높아지면, 식을 때까지 건드리지 마십시오.
- 제품이 작동하지 않을 경우 감전의 위험이 있으니 제품을 분해하지 마십시오. 수리가 필요한 경우 보청기 전문가에게 문의하십시오.
- 보청기는 유아, 영아, 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하세요. 습기제거제, 청소도구 등을 포함한 보청기 구성품 중 어떤 것도 삼키지 마십시오.
- 모든 케이블과 AC 어댑터는 국가인증시험소에 의해 승인을 받거나 목록에 있어야 합니다.

임상 효과

보청기는 삶의 질을 개선하고 의사소통을 용이하게 하기 위해 더 나은 어음인지도도를 제공하도록 설계되었습니다.

항공기에서 사용

보청기에 탑재된 무선 기능은 항공기 개인 전자기기 규정에서 면제되므로 기내 사용이 가능합니다.

안전정보

국제적 사용

보청기는 귀하의 국가 또는 지역 특정한 무선 주파수에서 작동하도록 승인되었으며, 귀하의 국가 또는 지역 밖에서 사용하도록 승인되지 않을 수 있습니다. 해외여행 중 작동이 다른 전자 기기에 간섭을 일으키거나 다른 전자 기기가 보청기에 간섭을 일으킬 수 있음을 유의하십시오

규정에 따라 다음의 경고 사항에 주의하세요:

⚠ 경고: 제대로 작동하지 않을 수 있으니 무선 보청기를 다른 전자 기기 주변에서의 사용을 피해야 합니다. 사용이 꼭 필요한 경우, 보청기와 다른 전자기기가 정상적으로 작동하는지 확인하시기 바랍니다.

⚠ 경고: 보청기 제조업체가 제공하는 것 이외의 액세서리, 구성품 또는 교체 부품의 사용은 전자기파 방출 증가 및 전자기파 면역성 감소를 초래하고 성능 저하를 가져올 수 있습니다.

⚠ 경고: 보청기로부터 30cm (12인 치) 이내의 거리에서 휴대용 무선 주파수 통신 장비가 사용되는 경우, 보청기의 성능 저하가 발생할 수 있습니다. 이런 현상이 발생하면, 통신 장비로부터 거리를 두시길 바랍니다.

⚠ 경고: 보청기의 안정성은 정상적인 사용 환경에서 설계되었습니다. 보청기를 착용한 상태에서 귀에 물리적 충격을 가하지 마십시오. 장치가 파손되거나 부품이 분리될 수 있으며, 외이도의 찢어짐 또는 고막의 천공을 초래할 수 있습니다. 이런 현상이 발생하면, 진단과 귀 내부에 있는 부품을 안전하게 제거하기 위해 의사의 진료를 받는 것을 권장합니다.

⚠ 경고: 보청기가 딱딱한 표면에 떨어지면 장치가 파손되거나 손상될 수 있으며, 이는 장치의 기계적인 스트레스나 충격을 포함합니다. 귀에 착용하기 전에 보청기가 손상되지 않았는지 확인하십시오. 장치가 손상된 경우, 즉시 사용을 중지하고 보청기 전문가에게 문의하십시오.

⚠ 경고: 보청기의 손잡이에 반복적인 압력을 가하면 파손될 수 있습니다. 손잡이가 끊어지거나 부러져 보청기를 안전하게 제거할 수 없다면, 안전하게 제거하기 위해 의사의 진료를 받길 권장합니다.

보청기를 분해하지 마십시오.

사용자가 직접 수리 가능한 부품은 없습니다.

멀티플렉스 이명 정보

스타키의 멀티플렉스 이명 기술은 이명 치료 프로그램의 일부로 사용할 수 있습니다. 멀티플렉스 이명 기술은 보청기를 통해 다양한 주파수와 크기의 이명 완화음을 들려주며, 이명 완화음은 청력 손실에 따라 설정되며, 보청기 전문가가 설정할 수 있습니다.

기능 안내

스타키 멀티플렉스 이명 기술은 보청기에 프로그래밍된 소리를 생성하는 소프트웨어 기능입니다. 보청기는 보청기, 이명 치료 기기, 또는 보청기 및 이명 치료 기기로서의 세 가지 작동 모드 중 하나로 사용될 수 있습니다.

멀티플렉스 이명 기술을 활성화하면 보청기 전문가가 사용자의 이명 완화 치료 계획에 맞춰 맞춤형 소리를 생성하고 프로그래밍할 수 있습니다.

멀티플렉스 이명 기술은 주파수와 진폭에서 변화하는 광대역 백색 소음 신호를 생성합니다. 이러한 특성은 보청기 전문가에 의해 조절되며, 사용자의 필요와 편안함을 위해 전문가가 설계한 처방된 치료에 특화되어 있습니다.

보청기 사용자는 신호의 레벨 또는 볼륨을 어느 정도 조절할 수 있으며, 이 조절과 신호의 편안한 수준과 소리에 대해 보청기 전문가와 상의해야 합니다.

⚠ 경고 : 사용 전 주의사항

다음의 증상을 가진 보청기 사용자는 이명 프로그램을 사용하기 전 의료면허를 소지한 귀 전문의와 상담하시길 권고합니다.

- i. 귀의 명백한 선천적 또는 외상성 변형.
- ii. 최근 90일 이내에 귀에서 중이염 등의 병력.
- iii. 최근 90일 이내에 갑작스럽거나 빠르게 진행되는 청력 손실 이력.
- iv. 급성 또는 만성 어지럼증.
- v. 최근 90일 이내에 발생한 편측성 청력 손실.

사용자를 위한 안내

스타키 멀티플렉스 이명 기술을 포함한 보청기는 이명(귀울림) 치료를 위해 충분한 강도와 대역폭의 소음을 생성하기 위한 전자 장치입니다. 또한 외부 소리 및 음성을 듣는 데 도움이 되기도 합니다.

멀티플렉스 이명 기술은 맞춤형 소리를 생성하는 도구입니다. 보청기 전문가와 적절한 상담 후 이명 관리 프로그램에서 사용하는 것을 권장하며, 이명으로 고통받는 사용자들에게 완화 효과를 제공하기 위해 사용되어야 합니다.

이명 치료 개념 및 이점

멀티플렉스 이명 기술은 이명 치료 프로그램의 일환으로 사용될 수 있습니다.

멀티플렉스 이명 기술은 보청기를 통해 백색 소음을 재생합니다.

멀티플렉스 이명 기술은 개개인의 청력상실 정도와 선호도에 따라 프로그래밍되며, 보청기 전문가는 멀티플렉스 이명 기술의 설정을 사용자의 요구에 맞춰 조정할 수 있습니다.

멀티플렉스 이명 기술은 일시적으로 이명의 완화 효과를 제공할 수 있습니다.

⚠ **주의사항:** 소리 발생 이명 치료 장치의 사용은 보청기 전문가나 청각 관리 전문가의 조언과 상담에 따라 이루어져야 합니다. 보청기 전문가는 청각 보조기를 개인 요구와 필요에 맞게 적절하게 진단하고 맞춤화합니다. 이는 규정된 이명 치료 프로그램에서의 사용을 포함합니다.

보청기 전문가는 적절한 후속 관리를 제공하며 사용자는 전문가의 조언에 따라 적응하는 것이 중요합니다.

⚠ **경고:** 소리 발생 이명 치료기기의 사용 시 일부 잠재적인 증상의 발생이 우려되며, 이는 대표적으로 이명의 악화, 청력 임계치의 변화, 청각 보조기와 접촉하는 부위에서 피부 자극이 발생하는 등의 증상이 포함됩니다.

멀티플렉스 이명 기술은 이러한 우려사항을 최소화하도록 설계되었습니다. 그러나 현기증, 구토, 두통, 심장의 두근거림에 해당하는 증상이 발생한 경우, 즉시 보청기의 사용을 중단하고 보청기 전문가 또는 귀 전문의와 즉시 상담 받아야 합니다.

모든 청각 보조기와 마찬가지로 이명 치료 기기의 오용은 일부 잠재적인 해로운 효과를 초래할 수 있습니다. 무단 사용을 방지하고 청각 보조기가 영아, 유아, 어린이와 애완동물의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 수 있도록 주의를 기울이십시오.

⚠ **주의사항:** 보청기를 최대 출력 레벨로 설정 후 하루에 16시간 이상 사용할 경우 소음 노출 한계를 초과할 가능성이 있습니다. 보청기 전문가가 설정한 소리가 편안한 수준을 초과하는 경우에도 보청기 사용을 즉시 중단 후 전문가에게 문의하시길 바랍니다.

안전정보

보청기 사용 예정자를 위한 주요 안내사항

가급적 이명이 있는 사람이 보청기를 사용하기 전에 귀 전문의의 의료 진단을 받아야 합니다.

의료 진단의 목적은 이명에 영향을 줄 수 있는 모든 의학적 치료 가능한 상태를 보청기를 사용하기 전에 확인하고 치료하는 것입니다.

이명 기술 데이터

멀티플렉스 이명 기술 최대 출력 = ANSI S3.22 또는 IEC 60118-7에 따라 2cc 커플러에서 측정 시 87 dB SPL(일반적)

넘어짐 감지 및 알림 기능

넘어짐 감지 및 알림 기능은 낙상이나 낙상과 관련이 있는 사고가 발생할 경우 보호자에게 알릴 수 있습니다. 해당 기능은 사전에 지정된 보호자 연락처로 알림 문자를 보내도록 설정할 수 있으며, 넘어짐 감지 및 알림 기능은 자동/수동으로 알림 문자를 보내도록 설정할 수 있습니다.

⚠ 경고: 자동 알림은 넘어짐을 100% 감지하지 못할 수 있습니다.

⚠ 경고: 민감도를 낮추면 넘어짐 감지 및 알림 기능이 일부 넘어짐은 감지하지 못할 수 있습니다. 예를 들어 다음과 같은 경우 넘어짐을 감지하지 못할 수 있습니다.

- 감도 설정이 사용자에게 적합하지 않은 경우.
- 매우 천천히 넘어지거나 점점 미끄러져 내려간 경우.
- 넘어진 직후 바로 일어나서 걷기 시작한 경우.

⚠ 경고: 자동 알림은 잘못 감지한 낙상으로 인해 문자를 발송할 수 있습니다. 잘못된 알림 문자가 보호자에게 발송되지 않도록, 스마트폰이나 보청기의 사용자 조절 버튼을 눌러 알림을 취소할 수 있습니다.

⚠ 경고: 넘어짐 감지 및 알림의 오작동을 줄일 수 있습니다.

- 보청기는 켜져 있어야 하며, 스마트폰과 블루투스*를 통해 연결되어 있어야 합니다.
- 스마트폰은 켜져 있어야 하며, 모바일 앱이 백그라운드에서 실행되고 있어야 합니다.
- 스마트폰은 인터넷에 연결되어 있어야 합니다.(모바일 데이터 또는 WiFi)

무선 기술 안내

보청기에는 2.4-2.4835 GHz 주파수 대역에서 작동하는 Bluetooth® Low Energy 무선 기술을 사용하는 송수신기가 포함되어 있습니다. GFSK 전송 변조를 사용하며 최대 효과를 내는 복사 전력은 -8 dBm (mRIC R), -6.2 dBm (RIC RT)입니다. 무선 수신부는 대역폭이 1.5 MHz입니다. RIC RT는 또한 10.281 MHz에서 작동하는 근접 필드 자기 유도를 사용하는 무선 송수신기를 포함하고 있으며, 측정 거리가 10미터인 경우 최대 유도 자기장 강도는 -5 dBuA/m이며 8-DPSK 전송 변조를 사용합니다. NFM의 RIC RT 수신부는 대역폭이 400 kHz입니다.

안전정보

이 보청기는 다음의 테스트를 통과하였습니다

- CISPR 11에 명시된 대로 그룹 1 클래스 B 장치에 대한 IEC 60601-1-2 방사 방출 요구사항.
- 80 MHz와 2.7 GHz 사이에서 필드 수준이 10 V/m인 RF 방사 면역 및 통신 장치로부터의 더 높은 필드 수준에 따른 IEC 60601-1-2 표 9.
- 30 A/m 필드 수준에서의 전력 주파수 자기장에 대한 면역성, 그리고 60601-1-2 표 11에 정의된 근접 자기장에 대한 면역성.
- +/- 8 kV 전도 방전 및 +/- 15 kV 공기 방전에 대한 ESD 수준의 면역성.

예상 사용 수명은 3년입니다.

무선 정보

mRIC R:	RIC RT:
FCC ID: EOA-24GENMICRO	FCC ID: EOA-24GENMACRO
IC: 6903A-24GENMICRO	IC: 6903A-24GENMACRO

EU 부작용 사례 보고

스타키 제품과 관련하여 발생한 중대한 사고는 귀하가 위치한 회원 국가의 유능한 당국 및 현지 스타키 대표에게 보고해야 합니다. 중대한 사고란 장치의 기능 이상, 특성 및 성능의 악화, 또는 사용자 설명서/라벨링의 불충분함으로 인해 사망하거나, 사용자의 건강 상태가 심각하게 악화되거나, 이러한 일이 반복될 경우를 말합니다.

FCC 정보

이 보청기는 FCC 규칙의 15부와 ISED 캐나다 면허면제 RSS 표준을 준수합니다. 작동은 다음 두 가지 조건에 의해 제한됩니다: (1) 장치는 유해한 간섭을 일으키지 않아야 하며, (2) 이 장치가 받은 모든 간섭을 받아들여야 하며, 이는 장치의 원치 않는 작동을 일으킬 수 있는 간섭을 포함합니다.

참고: 제조업체는 이 보청기에 대한 무단 개조로 인한 라디오 또는 TV 간섭에 대해 책임을 지지 않습니다. 이러한 개조는 사용자가 장비를 작동하는 권한을 무효화할 수 있습니다.

이에 Starkey Laboratories, Inc.는 mRIC R/RIC RT가 2014/53/EU 지침의 필수 요구 사항 및 기타 관련 규정을 준수하고 있음을 선언합니다. 준수 선언서는 아래 주소 또는 다음 사이트에서 받을 수 있습니다. docs.starkeyhearingtechnologies.com

이에 Starkey Laboratories, Inc.는 mRIC R/RIC RT가 수정된 UK Radio Equipment Regulations SI 2017을 준수하고 있음을 선언합니다. UK 준수 선언서는 다음 주소와 docs.starkeyhearingtechnologies.com에서 받을 수 있습니다.

규제정보

Starkey Laboratories, Inc.
6700 Washington Ave. South
Eden Prairie, MN 55344 USA
www.starkey.com



Starkey Laboratories (Germany) GmbH
Weg beim Jäger 218-222
22335 Hamburg
Germany

UK Authorised Person:
Starkey UK
William F. Austin House
Pepper Rd, Hazel Grove
Stockport SK7 5BX, UK
www.starkey.co.uk



전자 장비에서 발생하는 폐기물은
현지 규정에 따라 처리해야 합니다.



사용 설명서 참조



건조 보관

폐 전자기기 처리 안내

Starkey Laboratories, Inc.는 EU가 지역 사회법에 따라 보청기를 지역 전자 제품 재활용/폐기 프로세스를 통해 폐기할 것을 권장합니다.

아래 지침은 폐기/재활용 담당자의 편의를 위해 제공됩니다. 보청기를 폐기할 때 이 설명서를 첨부하십시오.

폐기/재활용 담당자를 위한 안내

이 보청기에는 리튬 이온 배터리가 포함되어 있습니다.
보청기에서 배터리를 분리하는 방법은 <https://web.starkeypro.com/conformity/regulatory-information.html> 을 참조하십시오.

규제정보

기호	기호 의미	적용 기준	기호 번호
	제조업체	BS EN ISO 15223-1:2021	5.1.1
	유럽 공동체 내 권한을 가진 대표	BS EN ISO 15223-1:2021	5.1.2
	제조원	BS EN ISO 15223-1:2021	5.1.3
	카탈로그 번호	BS EN ISO 15223-1:2021	5.1.6
	시리얼 번호	BS EN ISO 15223-1:2021	5.1.7
	의료 기기	BS EN ISO 15223-1:2021	5.7.7
	건조 보관	BS EN ISO 15223-1:2021	5.3.4
	온도 제한	BS EN ISO 15223-1:2021	5.3.7
	습도 제한	BS EN ISO 15223-1:2021	5.3.8
	주의사항	BS EN ISO 15223-1:2021	5.4.4
	일반 경고 표시	EC 60601-1, Reference no. Table D.2, Safety sign 2	ISO 7010-W001
	설명서/북클릿 참고	EC 60601-1, Reference no. Table D.2, Safety sign 10	ISO 7010-M002
	별도 수집	DIRECTIVE 2012/19/EU (WEEE)	Annex IX
	등급 장비	IEC 60417 Reference no. Table D.1	Symbol 9 (IEC 60417-5172)
	규제 준수 마크 (RCM)	AS/NZS 4417.1:2012	N/A
	기테키 마크	Japanese Radio Law	N/A
	직류	IEC 60601-1 Reference no. Table D.1	IEC 60417-5031
	재활용 기호	European Parliament and Council Directive 94/62/EC	Annex I-VII

사용 시 주의사항

1. 의료기기의 특성을 고려한 사용 대상 연령, 성별 또는 건강 상태 등에 대한 주의사항

- 보청기를 영아, 유아, 어린이, 치매노인, 애완동물이 삼킬 위험이 있으므로 삼키지 않도록 주의하십시오. 영아, 유아 또는 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 두고, 제품 박스 안의 청소 도구, 습기제거제 등 어떤 것도 섭취하지 않게 하십시오.

2. 상호작용

- 제품을 떨어뜨리거나 충격을 주지 말고, 진동이 심한 곳이나 자석(MRI 촬영) 종류가 있는 곳으로부터 멀리해 주십시오.

3. 보관/적용상의 주의

- 습기, 먼지나 그늘음 등이 많은 장소에 두지 마십시오.
- 절대로 임의로 분해, 수리하거나 개조하지 마십시오.
- 목욕탕, 찜질방 등 고온 다습한 환경에서 사용하지 마십시오. 보청기 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 직사광선이 들어오는 곳이나 난방 기구 등 열이 나는 곳, 온도가 너무 높은 곳이나 낮은 곳에 보관하지 마십시오.
- 화학 약품이나 세척제 등은 제품 표면과 성능을 변질시키므로 절대 사용하지 마십시오.
- 제품에 물이나 땀이 들어가면 내부 부품이 손상되어 문제가 발생할 수 있습니다. 물이 들어갔을 경우, 마른 헝겊으로 빨리 닦은 후, 보청기 전문가에게 점검을 받으십시오.
- 보청기에 물이 들어갔을 경우, 보청기를 건조하기 위해 헤어 드라이기, 전자레인지 등으로 가열하지 마십시오. 제품의 손상이나 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 보청기에 임의로 장식을 부착하거나 색을 칠하지 마십시오. 보청기에 임의로 장식을 부착하거나 색을 칠한 경우, 보청기 외관이나 표면이 변질되어 체질에 따라 알레르기 반응을 보일 수 있으며, 알레르기 반응을 보일 경우 보청기 착용을 멈추고 의사와 상담하시기 바랍니다.
- 보청기 착용 후 귀에 통증이나 염증 등의 이상 증상이 발생하면 반드시 의사와 상담하시기 바랍니다.
- 보청기 착용 시 매우 드물게 알레르기 반응이 일어날 수 있습니다. 만약 이상반응이 발생하면 보청기 착용을 멈추고, 의사와 상담하시기 바랍니다. 또한 실제 알레르기 반응이 일어났을 때 대체 가능한 이어몰드 재료가 있으니, 청각 전문가와 상담하시기 바랍니다.
- 귀에 심한 붓기나 분비물, 과도한 귀지 또는 기타 비정상적인 상태에 있다면 즉시 의사와 상담하시기 바랍니다.
- 전문의의 처방 또는 보청기 전문가의 상담에 따라 보청기를 구입, 사용하십시오.

※ 보청기는 개인의 청력 및 귀 모형에 맞게 제작되는 의료기기이므로 타인의 것을 사용하지 마십시오. 보청기의 잘못된 사용은 오히려 청력을 해칠 수 있으므로 전문의의 처방 또는 보청기 전문가의 상담에 따라 보청기를 구입, 사용하십시오.

4. 안전사고의 예방에 필요한 사항

- 사용자의 소중한 청각과 안전을 위해 스타키에서 제공하는 정품 부품을 사용하시기 바랍니다. 정품 부품이 아닌 경우 전자파 방출이 증가하고 성능이 저하될 수 있습니다. 정품을 사용하지 않아 발생하는 고장이나 안전사고에 대해서는 보장받으실 수 없습니다.
- 보청기 착용 시, 일시적으로 어지럼증이 발생할 수 있습니다. 이러한 경우 자동차 운전, 정밀기계 작동 등을 멈추고, 안정을 취한 후 착용하십시오. 만약 어지럼증이 지속될 경우, 의사와 상담하시기 바랍니다.



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play



(주)스타키코리아

08507, 서울특별시 금천구 가산디지털1로 128,
1706호, 1707호, 1708호, 1711호

T. 02-465-0999 **F.** 02-6466-2109

www.starkey.co.kr

작성년월 : 2023년 10월

Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to connect specifically to the Apple product(s) identified in the badge, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Apple, the Apple logo, iPhone, iPad and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. iOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.

Google Play is a trademark of Google LLC.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Starkey is under license. Intrigue, Starkey, and StarLink are trademarks of Starkey Laboratories, Inc.